

## Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

Jl. Karang Menjangan No. 22, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286 60286

0315035830

[bpfk-sby.org](http://bpfk-sby.org)



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Kefarmasian

# Uji Kesesuaian Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi

dan Alat Kesehatan / Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

No. SK : HK.02.03/E.X/344/2024

## Persyaratan

1. Pelanggan mengirim surat permohonan minimal berisi informasi identitas lengkap fasyankes (nama fasyankes, alamat, narahubung, alamat email) dan daftar jenis, jumlah alat/pesawat sinar-x yang akan dilakukan uji kesesuaian, pengujian kalibrasi, pengukuran paparan radiasi dan proteksi radiasi
2. Surat permohonan dapat diantar langsung ke BPAFK Surabaya, dikirim melalui jasa pengiriman, email [bpfksurabaya@kemkes.go.id](mailto:bpfksurabaya@kemkes.go.id), dan/atau WA ke 08155297818
3. Pelanggan menyiapkan petugas pendamping teknis untuk pengerjaan uji kesesuaian, pengujian kalibrasi, pengukuran paparan radiasi dan proteksi radiasi di lapangan
4. Pelanggan memastikan alat/pesawat sinar-x yang akan dikerjakan dalam kondisi baik (tidak rusak)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

Jl. Karang Menjangan No. 22, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286 60286

0315035830

[bpfk-sby.org](http://bpfk-sby.org)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan / Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

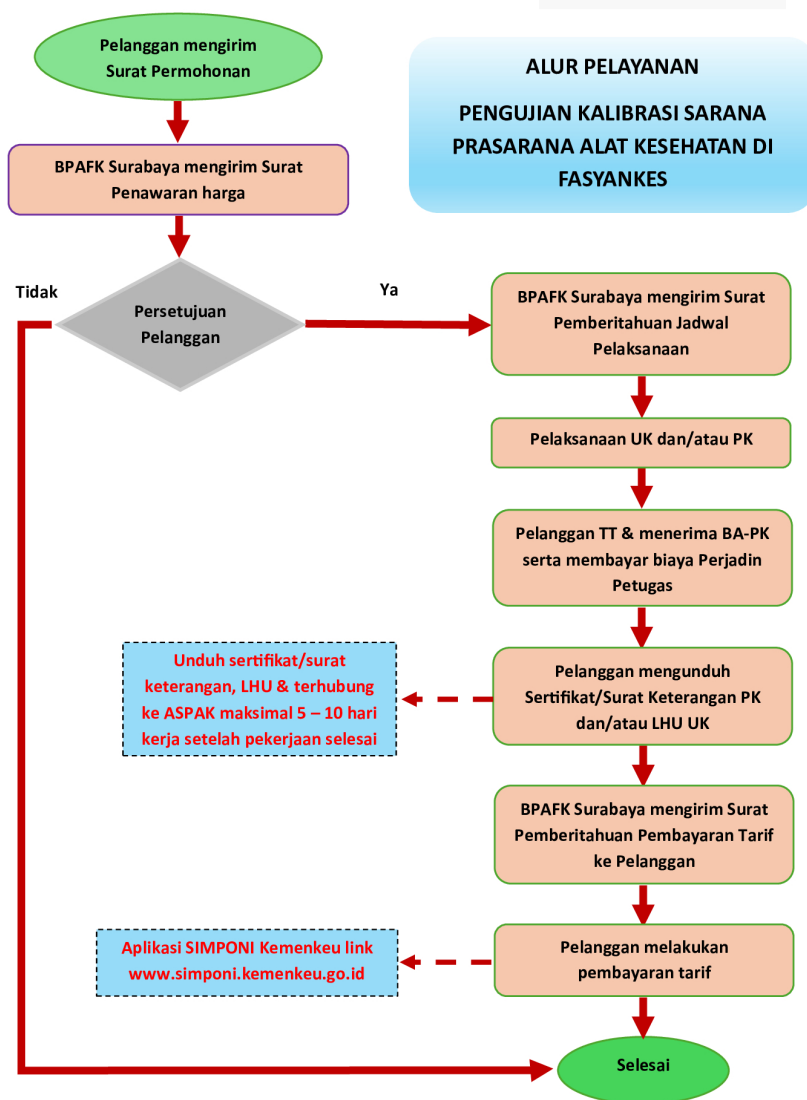

1. Petugas pelayanan teknis mengkaji daftar jenis alat/pesawat sinar-x, membuat surat penawaran harga yang berisi pola tarif alat, biaya operasional petugas, jumlah waktu pelaksanaan serta persyaratan - persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pelanggan
2. Surat penawaran harga dikirim melalui email/WA narahubung fasyankes
3. Pelanggan mengirim surat persetujuan penawaran maksimal 90 hari kalender sejak tanggal surat penawaran harga
4. Fasyankes yang setuju dengan penawaran akan dimasukkan kedalam antrian
5. Pelanggan mendapatkan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan uji kesesuaian/pengujian

## Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

Jl. Karang Menjangan No. 22, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286 60286

0315035830

[bpfk-sby.org](http://bpfk-sby.org)



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Kefarmasian

### Waktu Penyelesaian dan Alat Kesehatan / Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

0

- Penawaran harga diinformasikan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima
- LHU, sertifikat/surat keterangan beserta laporan teknis hasil uji kesesuaian, pengujian kalibrasi, pengukuran paparan radiasi dan proteksi radiasi terbit 5 - 10 hari kerja setelah pekerjaan selesai

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Biaya/tarif sesuai PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Biaya perjalanan dinas petugas sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun berjalan

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat/surat keterangan, Laporan teknis hasil pengujian kalibrasi/uji kesesuaian, LHU uji kesesuaian, Label

### Pengaduan Layanan

- Website : <https://bpfk-sby.org/public/pengaduan>
- Telepon : (031) 5035830
- [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
- Media sosial BPAFK Surabaya (IG, FB, Twitter)